NEOCHROM
ANALYTICAL TECHNOLOGIES

НЕОХРОМ АЗИЯ

Зертханаларға арналған
хроматографтар мен шешімдер

«НЕОХРОМ» лицензиарының сертификаты: ISO 9001:2015 SIC.MS.008. ISO9001.1814

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

Неохромға қош келдіңіз!

«Неохром Азия» ЖШС — халықаралық «НЕОХРОМ» сауда белгісінің лицензиясы бойынша NEOCHROM аналитикалық жабдығын өндіретін қазақстандық кәсіпорын. Зертханалар мен өндірістің міндеттерін шешуге арналған хроматографтар (масс-спектрометриялық детекторы бар үлгілерді қоса алғанда) және басқа аналитикалық жабдық шығарамыз.

МИССИЯ

• Ерекшеліктері, сапасы, пайдалану ыңғайлылығы және әділ бағасы арқылы тапсырыс берушіге қосымша құндылық беретін өнім шығару және қызмет көрсету.
• Нарықтың әртүрлі сегменттері үшін сапалы жабдық әзірлеу, сату және оған қызмет көрсету. Техникалық және пайдалану сипаттамалары бойынша бәсекеге қабілетті өнім жасау.
• Әр тапсырыс берушіге жеке тәсіл: нақты мақсаттар мен міндеттерге арналған NEOCHROM аналитикалық жабдығын әзірлеу, өндіру, енгізу және сүйемелдеу.
• Қаржылық мүмкіндіктері әртүрлі тапсырыс берушілерге NEOCHROM зертханалық жабдығының кең таңдауын ұсыну.
• Әріптестерімен бірлесіп тапсырыс берушінің міндеттерін шеше алатын кәсіби дилерлер желісін дамыту.
• Қызметкерлерді тұрақты жұмыспен, әділ еңбекақымен, қызықты жұмыспен, кәсіби өсу мүмкіндігімен және жақсы еңбек жағдайымен қамтамасыз ету.
• Жұмысымыздың негізі — тапсырыс берушінің қажеттіліктерін дәл түсіну және міндеттерін сапалы шешу.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ӨНДІРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Неохром Азия» ЖШС Қазақстанда «НЕОХРОМ» компаниясының лицензиясы бойынша физика-химиялық талдауға арналған жоғары дәлдікті аналитикалық аспаптар шығарады. NEOCHROM жабдығы мұнай химиясында, табиғи газды өндіру мен өңдеуде, агрохимияда, биохимияда, тамақ өнеркәсібінде, биологияда, медицинада, экологияда, криминалистикада, фармацевтикада және басқа салаларда зерттеулер мен күнделікті талдау үшін қолданылады.

Лицензиар — «НЕОХРОМ» компаниясы — әзірлеу мен өндіруде жиырма жылдан астам тәжірибесі бар, Украинада газ хроматографиясы жабдығын шығарады.

Неохром Азия NEOCHROM жинақтаған тәжірибеге сүйенеді. NEOCHROM шешімдері Украина мен басқа елдердің зертханаларында, өнеркәсіп кәсіпорындарында және ғылыми мекемелерінде табысты жұмыс істеп келеді.

NEOCHROM газ-хроматографиялық және спектрлік онлайн-бақылау жүйелері Украина мен ТМД елдерінің кәсіпорындарында қолданылады. «Неохром Азия» ЖШС Қазақстанда жабдықты жеткізуді, орнатуды, қызметкерлерді оқытуды және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырады. Біз «НЕОХРОМ» лицензиясы бойынша тапсырыс берушінің міндеттеріне сай жабдық шығарамыз, аспаптардың конфигурациясын таңдап, зертхананың аналитикалық міндеттерін шешуге көмектесеміз. Қазақстанда өндіру, жиынтықты келісу, жеткізу және қызмет көрсету мәселелері бойынша «Неохром Азия» ЖШС-не хабарласыңыз.

БӘСЕКЕЛІК АРТЫҚШЫЛЫҚТАР

- Қонымды бағадағы сапалы жабдық.
- Жыл сайын техникалық қызмет көрсету және салыстырып тексеру шартымен 7 жыл кепілдік.
- Қазақстандағы өндіруші — Павлодар қаласындағы «Неохром Азия» ЖШС; «НЕОХРОМ» лицензиясы бойынша өндіріс.
- Қазақстан зертханалары үшін жабдық өндіру және жеткізу.
- Тегін жаңартылатын, түсінікті бағдарламалық қамтылым.
- «НЕОХРОМ» лицензиарының өндірісі ISO 9001:2015 және ISO 14001:2015 бойынша сертификатталған.
- Әр NEOCHROM аспабы тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес тиісті әдістеме бойынша салыстырып тексеруден немесе калибрлеуден өтеді.
- Барлық NEOCHROM аспаптары жаңа, ағымдағы жылы шығарылған.
- ISO/IEC 17025:2017 бойынша аттестатталған зертханада тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқыту және тәжірибелік даярлау.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АСПАПТАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

NEOCHROM газ хроматографының негізгі функционалдық тораптары, басқару және визуалды бақылау құралдары, детекторлау жүйесі, температура мен газ шығынын бақылау жүйелері бір корпуста орналасқан.

NEOCHROM газ хроматографтары мына детекторлармен жабдықталады:
- Масс-селективті
- Жалынды-иондану
- Жалынды-фотометриялық
- Жылу өткізгіштік
- Термоэлектрондық
- Электрондарды қармау
- Фотоиондану
- Гелий-иондану
- Хемилюминесценттік

Қосымша жабдықтау мүмкіндіктері:
- Автосамплер
- Автоматты газ сынамасын енгізу крандары
- Қолмен басқарылатын газ сынамасын енгізу крандары
- Пиролизер
- Термодесорбер

Деректерді беру интерфейстері:
- USB
- ETHERNET (опция)

Деректерді өңдеу бағдарламасы:
- CDS NEOCHROM NG

NEOCHROM газ хроматографтары жетекші өндірушілердің капиллярлық колонкаларымен және жоғары сапалы полимерлік әрі бейорганикалық сорбенттер негізінде өзіміз өндіретін толтырмалы колонкалармен жабдықталады.

Жеткізу алдында әр колонка тапсырыс берушінің аналитикалық міндеттеріне сәйкес валидациядан өтеді.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ АСПАПТАР ҚАТАРЫ ХРОМАТОГРАФТАР

Арнайы конфигурацияларды қоспағанда, NEOCHROM хроматографтарының бүкіл қатарында талдау сезімталдығын анықтайтын бірдей электрондық компоненттер қолданылады. Бұл бағасы әртүрлі үлгілердің салыстырмалы сезімталдығын қамтамасыз етеді.

Қымбатырақ үлгілер оператордың жұмысын жеңілдететін, хроматографиялық деректерді талдау мен сақтау мүмкіндіктерін кеңейтетін және аспаптарды желіге біріктіруге мүмкіндік беретін қосымша модульдермен жабдықталған.



NEOCHROM Class A — қарапайым, сенімді және қолжетімді.

Газ шығынының қолмен басқарылатын реттегіштері. Масс-спектрометриялық детектордан басқа буландырғыштар мен детекторлардың барлық түрі қолжетімді. USB интерфейсі. Басты артықшылығы — ең төмен баға. Қолмен басқарылатын басқа аспаптардағыдай, ұсталу уақытының қайталанғыштығы автоматты басқарылатын үлгілерден төмен. Бұл класқа басқа өндірушілердің жаңғыртылған хроматографтары да жатады.



NEOCHROM Class B — тасымалдаушы газ шығынын электрондық реттеу.

Детекторлардың толық қатары. Сынама енгізу жүйелері: автодозатор, қолмен немесе автоматты басқарылатын газ сынамасын енгізу краны, пиролизер және басқалар. USB, ETHERNET (опция) интерфейстері. Ұсталу уақытының жоғары қайталанғыштығы.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ АСПАПТАР ҚАТАРЫ ХРОМАТОГРАФТАР



NEOCHROM Class C — кәсіби аналитикалық міндеттерге арналған.

Дербес жұмыс істеуге немесе сыртқы ДК-ге қосылуға арналған кіріктірілген компьютер. Аспаптарды желіге біріктіру, GSM-модем, GPS қосу. USB, COM және ETHERNET интерфейстері. Адам факторының әсерін азайту және талдауды тәуелсіз хаттамалау, соның ішінде хроматограмманы аспапта жазу маңызды болатын өндірістік зертханаларға арналған.



NEOCHROM Class SX — тапсырыс бойынша өндіру.

Газдарды, мұнай өнімдерін, полимерлердің пиролиз өнімдерін және басқа көпкомпонентті қоспаларды онлайн-бақылауды қоса алғанда, тапсырыс берушінің міндеттеріне арналған аналитикалық жүйелер. Масс-селективті, гелий-иондану және басқа детекторлармен қосымша жабдықтау.

ЖАҢҒЫРТУ

Хроматографтың мүмкіндіктерін жаңартыңыз. Біздің шешім: https://neochrom.asia/ru/posluhy/modernizaciya.html
Хроматографыңыздың жаңартылған корпусындағы заманауи электроника. Бастапқы маркасына қарамастан, аспап CLASS A сериясының техникалық шарттары бойынша аттестаттаудан және салыстырып тексеруден өтеді. Суретте — жаңғыртудан кейінгі CHROM 5. Жаңғыртылған жабдыққа кепілдік — 1 жылдан 3 жылға дейін.



© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

NEOCHROM газ хроматографтары өнеркәсіп, энергетика, металлургия, ауыл шаруашылығы, ғылым, медицина және басқа салалардың аналитикалық міндеттерін шешеді.

Трансформатор майын талдау

• Оқшаулағыш трансформатор майындағы еріген газдар: СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006, ASTM D3612.
• Оқшаулағыш трансформатор майындағы «ионол» антиоксидант қоспасының мөлшері: СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006.

Табиғи газды талдау

• Табиғи газдың компоненттік құрамы: ISO 6974:2007.
• Табиғи газдың физика-химиялық қасиеттері: ISO 6976:2009.

Қоршаған орта мен тағамдағы бенз(а)пиренді және басқа ПАК-тарды анықтау

• Атмосфералық ауадағы полициклді ароматты көмірсутектер: ISO 12884:2000.
• Атмосфералық және жұмыс аймағы ауасындағы бенз(а)пирен: МУК 4.1.1273-03.

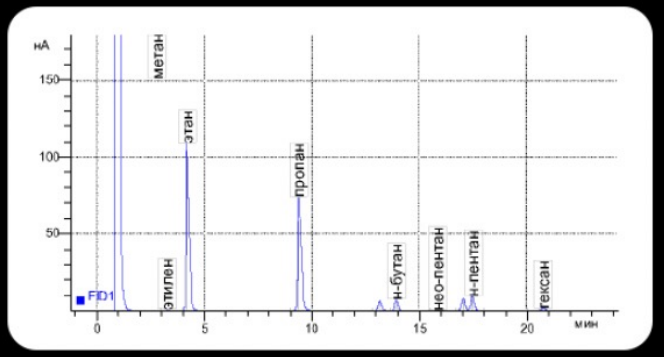

*Осы және кейінгі хроматограммаларға қатысты.

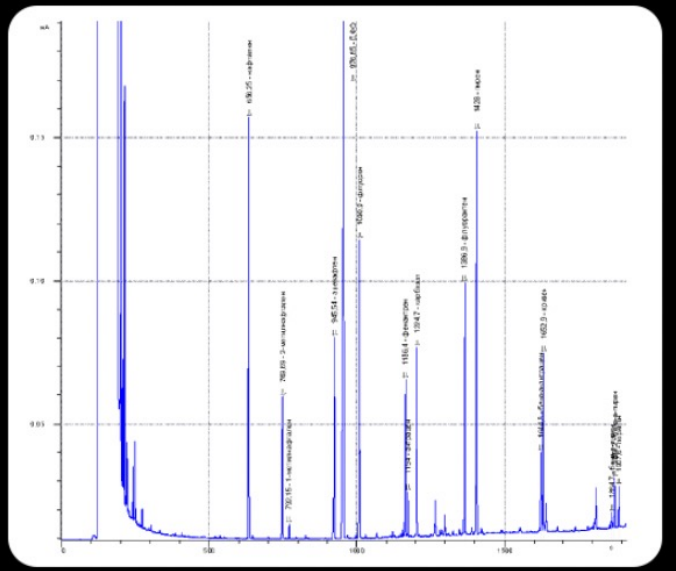

*Хроматограммалар NEOCHROM газ-хроматографиялық жабдығында алынған және белгілі шектеулермен нақты нәтижелерді көрсетеді. Компания бұл материалдарды тәжірибеде қолданудан туындаған тікелей немесе жанама залал үшін жауап бермейді.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM
ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Азық-түлік пен шикізатты зерттеу

- Пестицидтерді анықтау
- Микотоксиндерді анықтау
- Нитрозаминдерді анықтау
- Гормондарды анықтау

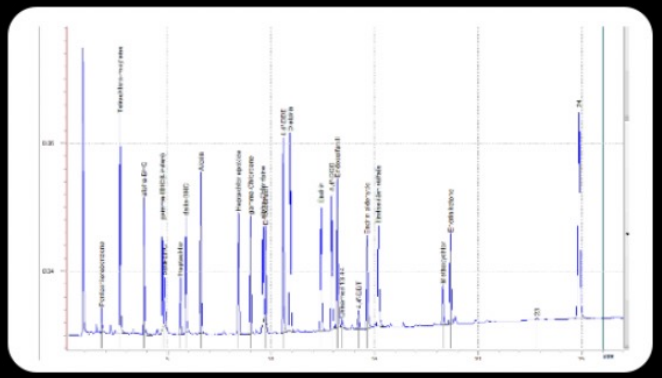

Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды, күшті әсер ететін және улы заттарды зерттеу

- Сапалық газ-хроматографиялық талдау
- Сандық талдау
- Ортақ шығу көзін анықтау үшін сәйкестендіру (салыстырмалы талдау)

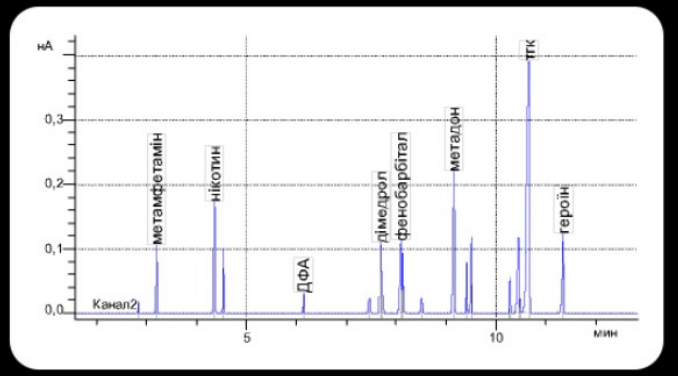

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Май өнімдерінің сапасын анықтау

• ISO 15885 бойынша сүт өнімдерінің май қышқылдық құрамын анықтау.
• Май қышқылдарының транс-изомерлерін анықтау.

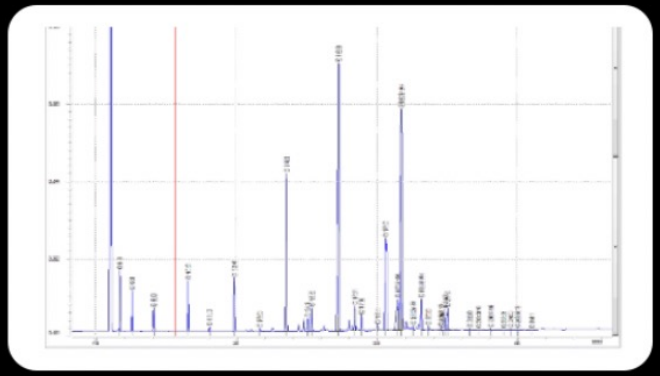

• Триглицеридтердің газ хроматографиясы әдісімен сүт майының тазалығын анықтау: ISO 17678.

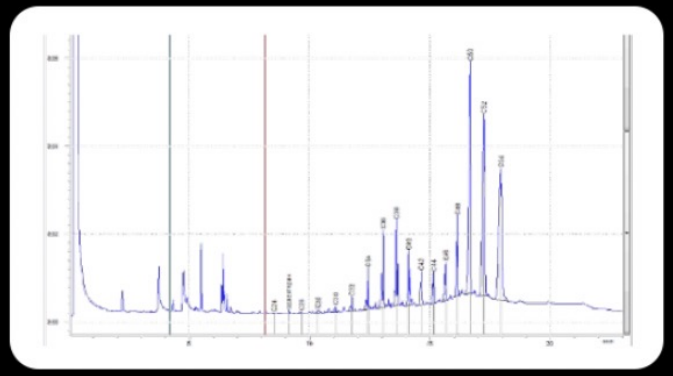

• Стериндердің газ хроматографиясы әдісімен өсімдік майын анықтау: ISO 3594.

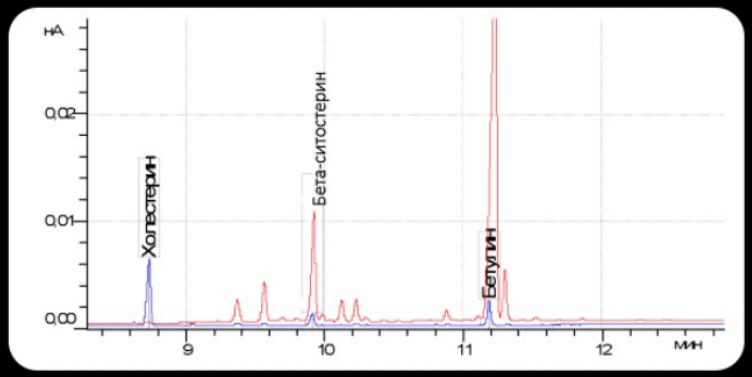

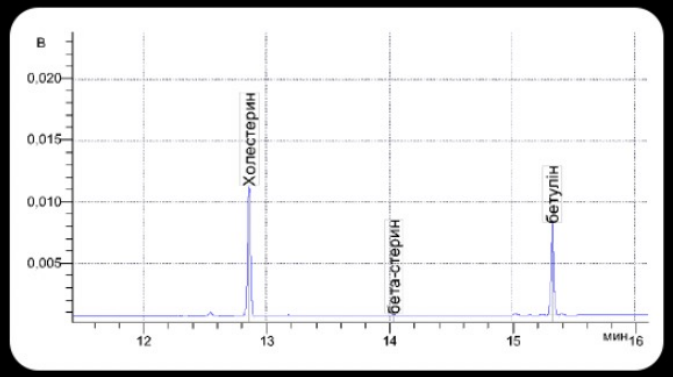

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Құрамында спирт бар сұйықтықтардың сапасын зерттеу

• Тағамдық және медициналық спирттің сапасы: улы микроқоспаларды, сивуш майларын, қышқылдарды және т.б. анықтау.
• Спиртті сусындар: ДСТУ, ГОСТ талаптарына сәйкестігі және түпнұсқалығын тексеру.
• Коньяктар: түпнұсқалығын бағалау үшін жас маркерлерін анықтау.
• Биоэтанолды (мотор отынына қоспа) зерттеу.
• Өнеркәсіптік спирттер: денатурациялаушы компоненттер мен құрамның сәйкестігі.

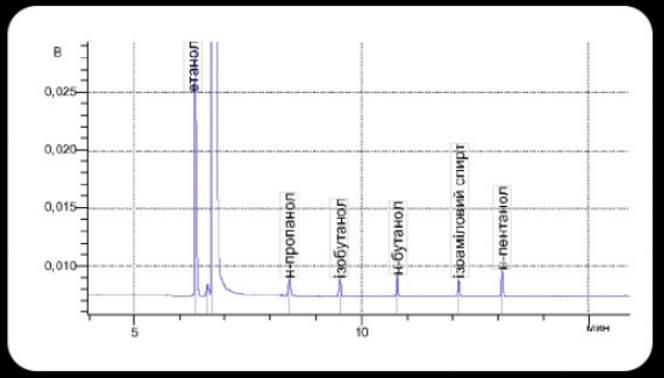

Биологиялық нысандардағы алифатты спирттер мен басқа ұшпа компоненттерді зерттеу

• Этил спиртін анықтау
• C1-C5 алифатты спирттерін анықтау
• Биологиялық нысандардағы ұшпа улы компоненттерді анықтау

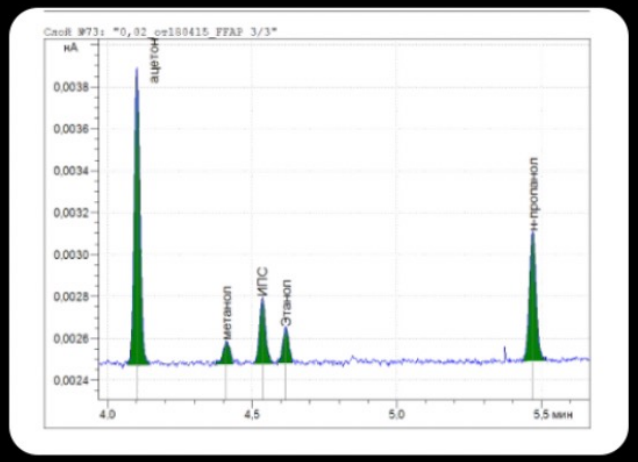

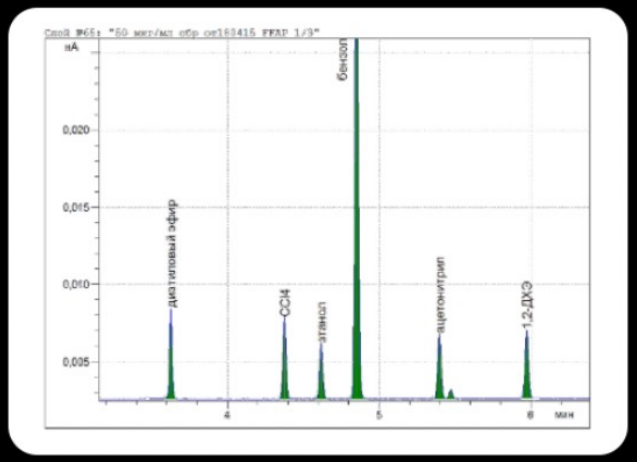

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Отын мен басқа мұнай өнімдерінің сапасын зерттеу

- Бензин сапасын зерттеу
- Биодизель сапасын зерттеу
- Дизель отынының сапасын зерттеу
- Минералды, жартылай синтетикалық және синтетикалық майлардың сапасын зерттеу
- Қоспаларды талдау

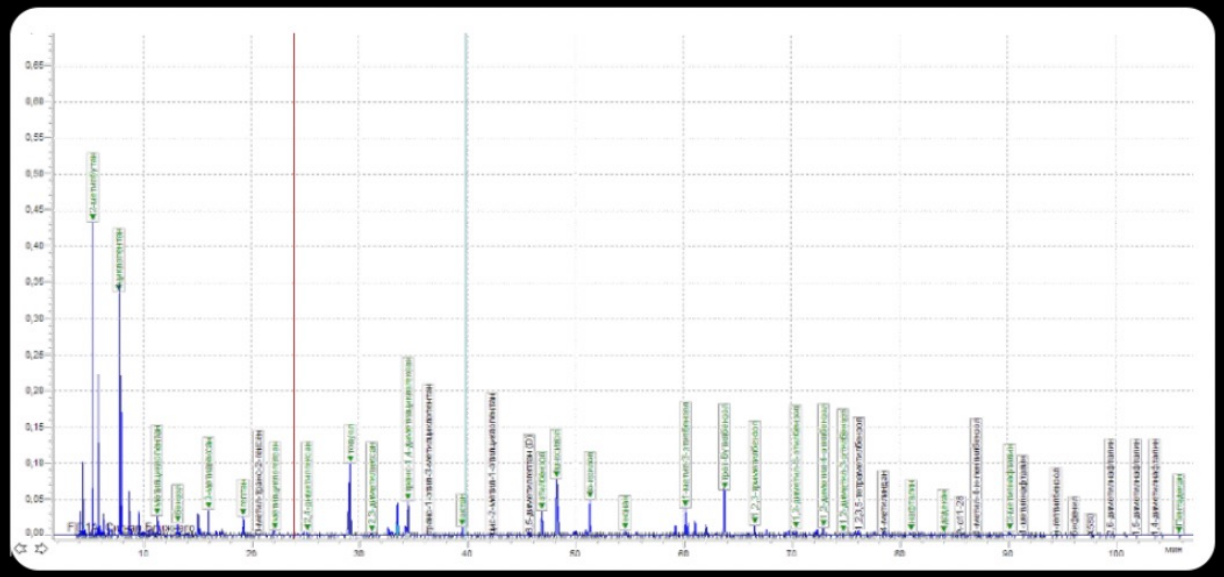

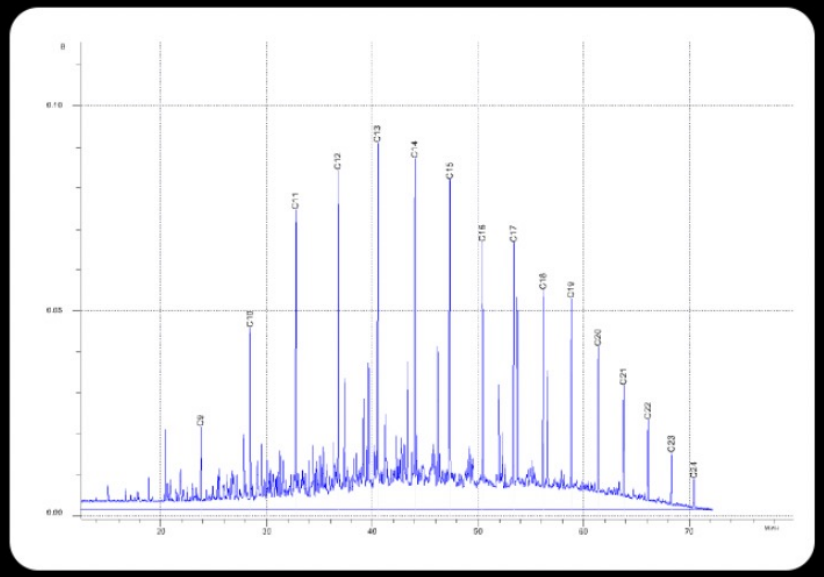

Биоэтанол мен басқа органикалық еріткіштердегі суды анықтау

Биоэтанол бензин қоспасындағы су мөлшерін арттырып, коррозия мен микроорганизмдердің өсу қаупін күшейтуі мүмкін. Этанол өндірушілері өнімдегі ылғалды барынша азайтуы қажет. Жылу өткізгіштік детекторы бар газ хроматографиясы спирттегі суды 0,03%-дан бастап анықтауға мүмкіндік береді.
Гелий-иондану детекторы суды 1 ppm деңгейінде анықтай алады.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

АНАЛИТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРГЕ ДАЙЫН ШЕШІМДЕР

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Шахта атмосферасындағы күрделі газ қоспаларын талдау

NEOCHROM газ-хроматографиялық кешендері шахта атмосферасын талдайды. Анықталған компоненттердің арақатынасы эндогендік өрттерді диагностикалау және болжау үшін пайдаланылады.

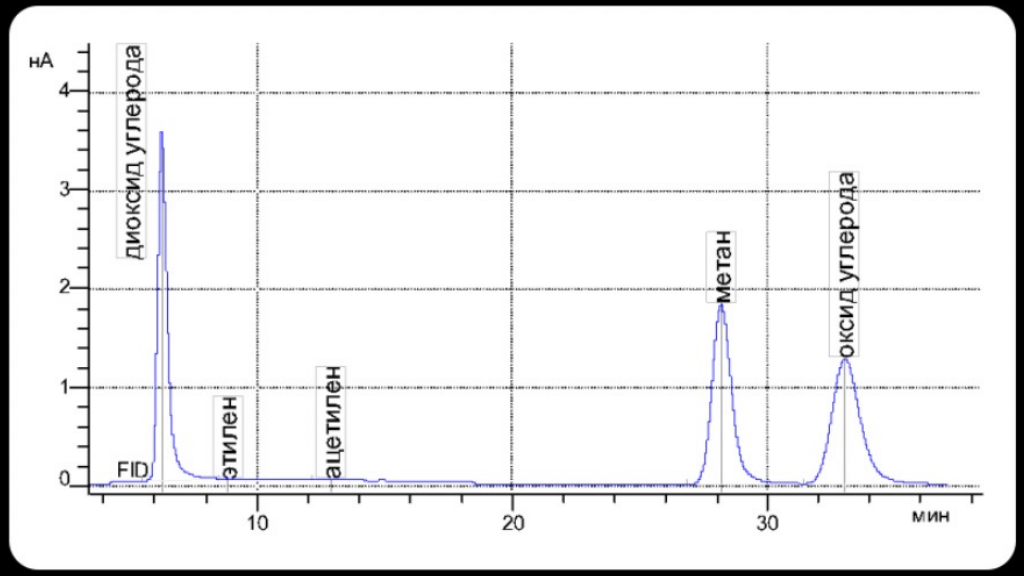

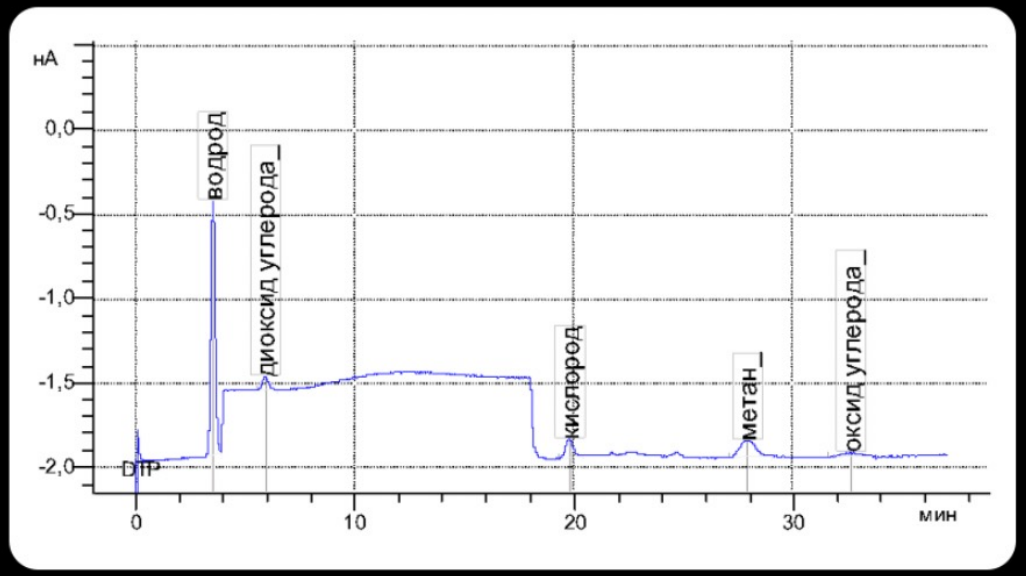

Қызметкерлердің біліктілігі мен компанияның материалдық-техникалық базасы тапсырыс беруші көрсеткен әдістемелер, нормативтік құжаттар және ұсынымдар негізінде шешімдер әзірлеуге мүмкіндік береді.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ТАЗА ГАЗ ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ӨНДІРУ

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

HMG сутек генераторлары

Ерекшеліктері мен артықшылықтары

• SPE қатты полимерлік электролит технологиясы (solid polymer electrolyte).
• Сілтісіз таза суды тікелей электролиздеу.
• Жоғары сапалы ион алмасу мембранасы.
• Күкірт мөлшері төмен O-ring тығыздағышы газ тазалығын сақтауға көмектеседі.
• Газ тазалығы жалынды-иондану, термоэлектрондық және масс-спектрометриялық детекторлармен жұмыс кезінде тұрақты базалық сызықты қамтамасыз етеді.
• Газ қысымы мен шығынын кіріктірілген бақылау.
• Су деңгейін автоматты бақылау және су жетіспегенде өшіру.
• Қызмет мерзімін ұзартатын электролизер қорғанысы.
• Әртүрлі өндірушілердің газ хроматографтарымен үйлесімділік.
• Қосылыстар мен коммуникациялық шығыстар әдепкіде NEOCHROM газ хроматографтарына бейімделген.



© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ТАЗА ГАЗ ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ӨНДІРУ

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

HMG сутек генераторлары

Техникалық параметр	HMG-300*	HMG-500**	HMG-1000***
Сутек тазалығы	99.999%	99.999%	99.999%
Шығыс ағыны	300 мл/мин	500 мл/мин	1000 мл/мин
Шығыс қысымы	0-0,4 МПа	0-0,4 МПа	0-0,4 МПа
Қысымды өтеу	0,01 МПа	0,01 МПа	0,01 МПа
Қуат	150 Вт	250 Вт	250 Вт
Өлшемдері, массасы	360×300×140 мм, 14 кг	400×360×220 мм, 14 кг	400×360×220 мм, 14 кг

* Иондану детекторларын қоректендіруге немесе ұзындығы 50 м-ден қысқа капиллярлық колонкаға тасымалдаушы газды қатар беруге ұсынылады, егер әдістегі сынама ағынын бөлу коэффициенті 100-ден аспаса.

** Иондану детекторларын қоректендіруге немесе ұзындығы 50 м-ден қысқа капиллярлық колонкаға тасымалдаушы газды қатар беруге ұсынылады, егер әдістегі сынама ағынын бөлу коэффициенті 250-300-ден аспаса.

*** Газ шығыны жоғары болғанда жұмыс істеуге ұсынылады.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ТАЗА ГАЗ ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ӨНДІРУ

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

NEOCHROM NG сериялы азот генераторлары

Ерекшеліктері мен артықшылықтары

• Қысым мен шығынды автоматты көрсету, тұрақты қысым мен токты сақтау; азот ағыны тұтынуға қарай автоматты реттеледі.

• Электролиттік ұяшықта мембраналық бөлу. Каталитикалық қабаттағы PCAN тасымалдағышы мен бағалы металл катализаторы ұяшықтың тиімділігін, жоғары өнімділікті және азот тазалығын қамтамасыз етеді.

• Тұрақты жұмысты қамтамасыз ету үшін жеткізу алдында электролиттік ұяшық жоғары кернеу мен токта 100 сағаттан астам қартаю сынағынан өтеді.

• Алынатын азоттың ылғалдылығы төмен: молекулалық өткізгіштігі жоғары мембраналық бөлу және металл-полимерлік кептіру құрылғысы бастапқы ылғал мөлшерін азайтады.

• Екі адсорбциялық жүйе шық нүктесін қосымша төмендетіп, азот тазалығын арттырады. Белсендіруді қажет етпейтін оттек іздерін кетіру құралы қарастырылған.

• Пайдалану оңай: тазарту баллондарын тасымалдау мен оларға қызмет көрсету қажет емес. Азот алу үшін генераторды қосу жеткілікті. Шығынды төмендетпей, азотты тұрақты берумен үздіксіз немесе мерзімді жұмыс істеуге болады.

• Қауіпсіздік пен сенімділік: сезімтал автоматты қорғаныс құрылғысы сілтінің өтуіне жол бермейді.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ТАЗА ГАЗ ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ӨНДІРУ

NEOCHROM ANALYTICAL TECHNOLOGIES

NEOCHROM NG сериялы азот генераторлары

Параметр	NG-300*	NG-500**	NG-1000***
Азот тазалығы	Оттек <3 ppm	Оттек <3 ppm	99.999%
Шығыс ағыны	0-500 мл/мин	0-500 мл/мин	0-1000 мл/мин
Шығыс қысымы	0-0,4 МПа	0-0,4 МПа	0-0,4 МПа
Қысым ауытқуы	<0,003 МПа	<0,003 МПа	<0,003 МПа
Қуат көзі	220 В ±10%, 110 В ±10%	220 В ±10%, 110 В ±10%	220 В ±10%, 110 В ±10%
Тұтынылатын қуат	60 Вт	100 Вт	150 Вт
Жұмыс ортасы	Температура 0-45 °С, салыстырмалы ылғалдылық 85%	Температура 0-45 °С, салыстырмалы ылғалдылық 85%	Температура 0-45 °С, салыстырмалы ылғалдылық 85%
Өлшемдері, массасы	370×180×330 мм, 11 кг	370×180×330 мм, 11 кг	370×180×330 мм, 20 кг

* Иондану детекторларын қоректендіруге немесе ұзындығы 50 м-ден қысқа капиллярлық колонкаға тасымалдаушы газды қатар беруге ұсынылады, егер әдістегі сынама ағынын бөлу коэффициенті 100-ден аспаса.

** Иондану детекторларын қоректендіруге немесе ұзындығы 50 м-ден қысқа капиллярлық колонкаға тасымалдаушы газды қатар беруге ұсынылады, егер әдістегі сынама ағынын бөлу коэффициенті 250-300-ден аспаса.

*** Газ шығыны жоғары болғанда жұмыс істеуге ұсынылады.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

ЗЕРТХАНА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ


SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості

Сертифікат №: SIC.MS.008.ISO9001.4221

Орган сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації»
цим сертифікатом підтверджує, що система менеджменту якості

CHROM NEOR&D

«НЕОХРОМ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
69006, Україна, м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 30
Код ЄДРПОУ: 40108117

стосовно:

- виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- ремонту і технічного обслуговування інших машин і устаткування;
- виробництва хроматографів, спектрофотометрів, спектрометрів інфрачервоної області поглинання з Фур'є перетворенням, мас-спектрометрів з індуктивно-зв'язаною плазмою та оптико-емісійних спектрометрів;
- розробки аналітичного устаткування під замовлення;
- розробки контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА);
- модернізації аналітичного устаткування;
- розробки та впровадження методів лабораторних досліджень в області хімічної промисловості;
- очистки, виробництва хімічних розчинників та реактивів, стандартних зразків

відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015

«Системи менеджменту якості. Вимоги»

(ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT);
(ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги»
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Дата видачі сертифікату	:	25.10.2024
Цикл сертифікації	:	3 роки (до 24.10.2027)
Термін дії сертифікату*	:	24.10.2025
Дата наступного підтвердження	:	25.09.2025

** Сертифікат підлягає перевидачі на новий термін за результатами щорічного підтвердження*

Керівник органу Є. Колєсніков

ISO 9001 SIC.MS.008.ISO9001.4221

GAS

Бюро Міжнародної Сертифікації, 04210, вул. Оболонська набережна 19, корп. 4, оф. 14, Київ, Україна
Тел.: +380676929691, info@bic-cert.com.ua, Атестат акредитації: GAS.CB.804.008 від 11.01.2022 р., видан Global Accreditation System (GAS)
www.sic-global.com

Компания серіктесі — «Тапсырыстық зерттеулер зертханасы»

ISO 17025 стандарты бойынша сертификатталған зертхана өнімді сынау, ғылыми зерттеу, өнімнің құрамы мен рецептурасын анықтау (бенчмаркинг) және оның түпнұсқалығын анықтау қызметтерін көрсетеді.

Зертханада физика-химиялық, хроматографиялық және спектрлік зерттеу бөлімдері жұмыс істейді. Газ және сұйықтық хроматографтары, көрінетін және ультракүлгін аймақ спектрофотометрлері, Фурье-түрлендірулі инфрақызыл спектрометрлер, атомдық-абсорбциялық спектрофотометр, индуктивті байланысқан плазмалы масс-спектрометр және басқа аспаптар қолданылады. Аналитикалық және қосалқы жабдық, арнайы жабдықталған үй-жайлар, әдістемелік база және білікті мамандар тапсырыс берушілердің кең ауқымды зерттеу міндеттерін шешуге мүмкіндік береді.

Зертхана жаңа өлшеу әдістемелерін әзірлеп, оларды әртүрлі ұйымдардың тәжірибесіне енгізеді.

Зертхана базасындағы оқу орталығы Украина мен басқа елдердің кәсіпорындары мен ұйымдары үшін тапсырыс берушілердің қызметкерлерін NEOCHROM хроматографиялық жабдығымен және басқа аналитикалық аспаптармен жұмыс істеуге үйретеді.

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1

NEOCHROM
ANALYTICAL TECHNOLOGIES

«НЕОХРОМ АЗИЯ» ЖШС

Қазақстандағы NEOCHROM өндірушісі
«НЕОХРОМ» лицензиясы бойынша

Компания деректемелері
БСН 260340032992

140003, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.
Толстой көшесі, 90/69
Тел.: +7 (771) 456 0174

Ынтымақтастық мәселелері
Константин Топчий
ceo@neochrom.asia

Техникалық мәселелер
Олексій Сериков
os@neochrom.asia

www.neochrom.asia

© Бұл құжатты кез келген нысанда NEOCHROM-ASIA LLC компаниясының жазбаша рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға тыйым салынады. urn:nc_DC.PW:LE.v21.130820.1